ENDO
KEIR SURGICAL

FIÈREMENT CANADIEN
DEPUIS PLUS DE 100 ANS

Endoscopie flexible

Avec :

PMC™
LES BROSSES

2026

PRODUITS POUR L'ENDOSCOPIE FLEXIBLE

Chez Keir Surgical, nous nous efforçons continuellement de répondre aux besoins et aux défis des hôpitaux et des cliniques canadiennes en offrant des produits de haute qualité au meilleur prix possible. Notre objectif est la satisfaction du client.

ENDOSCOPIE FLEXIBLE

Une gamme complète de produits pour l'entretien des endoscopes :
• Kits de pré-nettoyage enzymatique au chevet, brosses de nettoyage, protecteurs d'embouts, plateaux de transport, équipements de séchage et de vérification du nettoyage.

Dispositifs et accessoires pour la gastro-entérologie et la bronchoscopie :
• Protecteurs buccaux, pinces à biopsie, brosses de cytologie, aiguilles, anses, dispositifs de récupération et trappes à polypes.

Tous nos produits d'endoscopie sont garantis SANS LATEX.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Mise à jour : avril 2026

Commandes
Commandez par télécopieur au 604.261.9549, par courriel à orders@keirsurgical.com
ou par EDI via Global Healthcare Exchange (GHX). Pour toute question, veuillez appeler le 1.800.663.4525.

Expédition et modalités
Nos produits sont expédiés FAB pour les commandes supérieures à 1 000 $, sauf indication contraire. Le FAB ne s'applique pas aux régions éloignées. Les modalités de paiement sont nettes à 30 jours. En raison de la fluctuation des coûts, Keir Surgical se réserve le droit de modifier les prix sans préavis. Les prix en vigueur au moment de la commande prévalent.

Marchandises retournées
Pour retourner des marchandises, un numéro d'autorisation de retour doit d'abord être obtenu auprès de notre service à la clientèle au 1.800.663.4525. Tous les articles retournés doivent être soit non ouverts, soit stérilisés. Keir Surgical n'acceptera pas le retour d'articles utilisés et non stérilisés. Tous les articles retournés sont sujets à une inspection par Keir Surgical et/ou le fabricant du produit avant l'émission d'un crédit ou d'un remplacement. Le retour de colis non ouverts et non marqués ne sera accepté que dans les 30 jours suivant la date de facturation. Tous les retours sont soumis à des frais de réapprovisionnement de 20 %, sauf si Keir Surgical et/ou le fabricant considèrent que le produit présente un défaut de fabrication ou une erreur de distribution.

Informations sur les produits et garantie
Keir Surgical est certifiée selon le système de gestion de la qualité ISO, et nos instruments chirurgicaux de marque KS sont couverts par une garantie à vie contre les défauts de fabrication et de matériaux. Les dommages causés par une mauvaise utilisation d'un produit et l'usure normale ne sont pas couverts par la garantie. Nos instruments de qualité salle de soins de marque KB sont couverts par une garantie de six mois contre les défauts de fabrication et de matériaux. Les dommages causés par une mauvaise utilisation d'un produit et l'usure normale ne sont pas couverts par la garantie. Ces produits ne sont pas conçus pour offrir le même rendement ni la même durée de vie qu'un instrument de qualité bloc opératoire. Chaque fournisseur que nous représentons offre ses propres garanties. Veuillez communiquer avec notre siège social ou avec votre représentant de territoire pour obtenir une copie de ces garanties. Toute décision relative à la garantie sera prise par le siège social de Vancouver.

Vos idées et vos commentaires sont les bienvenus
Si vous avez une suggestion pour un nouveau dispositif ou une amélioration d'un dispositif existant, n'hésitez pas à nous communiquer vos idées.

Avis de non-responsabilité
Toutes les recommandations de brosses faites par Keir Surgical ne sont que des suggestions. En raison de la variété des instruments disponibles sur le marché, les utilisateurs finaux sont les mieux placés pour choisir la brosse la plus adaptée à leurs besoins et assument la responsabilité de leurs choix.

*Veuillez noter que toutes les images ou photos contenues dans notre catalogue sont uniquement destinées à la démonstration des produits et ne sont en aucun cas destinées à être instructives ou à fournir une autorité sur l'utilisation acceptable des produits.

TABLE DES MATIÈRES

DISPOSITIFS ET ACCESSOIRES GI

Trappes à Polypes 6
Protecteurs Buccaux 8
Capuchons de Valve de Biopsie 9
Endoscopie Capsulaire 10
Dispositifs de récupération 11
Anses de Polypectomie 12
Aiguilles d'injection 15
Pinces À Biopsie 18
Brosses de Cytologie et de Microbiologie 20
Dilatateurs à Ballonnet 22
ERCP Stents 24
Cathéters de Pulvérisation 27

DISPOSITIFS ET ACCESSOIRES PULMONAIRES

Inhalothérapeutes – Accessoires endotrachéaux 29
Protecteurs Buccaux 31
Dispositifs de Récupération 32
Pinces À Biopsie 34
Brosses de Cytologie et de Microbiologie 36

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES ENDOSCOPES

Équipement d'Endoscopie 40
Nettoyage des Endoscopes 44
Détergents Enzymatiques 50
Protection et Transport des Endoscopes 52

INDEX DES PRODUITS 59

Avec : PMC™ LES BROSSES

KS KEIR SURGICAL

ENTRETIEN DES ENDOSCOPES KEIR SURGICAL



Nous sommes heureux de proposer la réparation des endoscopes flexibles dans un seul programme pratique.





Tarification échelonnée selon le niveau de réparation!

FEO CORRECT™

PROGRAMME DE SOLUTION COMPLÈTE KEIR SURGICAL

CE QUE NOUS OFFRONS :

- **Délai d'exécution rapide :** réparations effectuées dans nos installations ultramodernes de Vaughan, en Ontario.
- **Haute qualité :** certifié ISO 13485 et une équipe de techniciens cumulant plus de 250 ans d'expérience en réparation d'endoscopes OEM Correct™.
- **Économies de coûts :** des économies significatives par rapport aux réparations d'origine.

SOLUTION COMPLÈTE
KS

DISPOSITIFS ET ACCESSOIRES GI

TRAPPES À POLYPES 6
PROTECTEURS BUCCAUX 8
CAPUCHONS DE VALVE DE BIOPSIE 9
ENDOSCOPIE CAPSULAIRE 10
DISPOSITIFS DE RÉCUPÉRATION 11
Boucle à Griffes 11
Filets 11
Dents de Rat 12
ANSES DE POLYPECTOMIE 12
Hybrides, Froides et Chaudes 13
AIGUILLES D'INJECTION 15
Hémoclip Endoscopique 17
PINCES À BIOPSIE 18
Pinces Standard 18
Pinces Jumbo 19
BROSSES DE CYTOLOGIE ET DE MICROBIOLOGIE 20
DILATATEURS À BALLONNET 22
ERCP STENTS 24
Stents Biliaires 24
Stents Pancréatiques Flexi 25
CATHÉTERS DE PULVÉRISATION 27

TRAPPES À POLYPES

À usage unique

Chambre simple

Permet de recueillir un seul polype ou plusieurs. Réduisez les coûts en évitant de jeter des chambres vides. Gardez un assortiment en inventaire !

CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
PT-25	Couvercle fileté, connecteur bleu	25
PT-25X	Couvercle fileté	25
PT-100	Couvercle fileté, connecteur bleu	100
PT-100X	Couvercle fileté	100
KS02-8001	Chambre simple, couvercle transparent	40



KS02-8001



PT-100X



PT-100

800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

TRAPPES À POLYPES


À usage unique

Chambres multiples

CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
KS02-8004	4 chambres	25
KS02-8002	Accès rapide, 2 tiroirs	25



KS02-8004

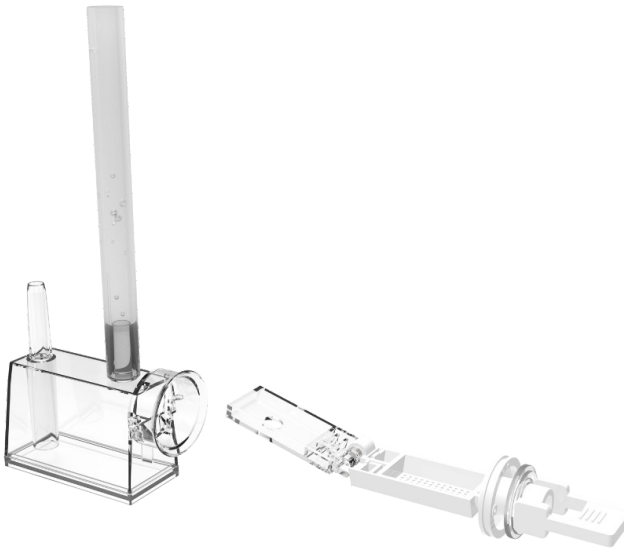

KS02-8002

PROTECTEURS BUCCAUX

À usage unique



KS02-9016



KS02-9016N




KS02-9019



KS02-9020



KS02-9021

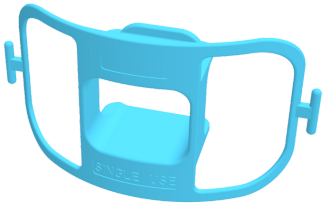

KS02-9022

CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	QTÉ PQT
KS02-9016	Orange avec sangle	16 mm / 48 FR	100
KS02-9016N	Orange sans sangle	16 mm / 48 FR	100
KS02-9019	Bleu sans sangle	18 mm / 54 FR	100
KS02-9020	Bleu avec sangle	20 mm / 60 FR	25
KS02-9021	Adulte, rond, coussin de confort	27 mm x 21 mm / 82 FR x 64 FR	50
KS02-9022	Adulte, carré, coussin de confort	27 mm x 22 mm / 82 FR × 67 FR	50

800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

CAPUCHONS DE VALVE DE BIOPSIE

À usage unique



16-0002



16-0004



16-0022




16-0044

CODE	DESCRIPTION	COULEUR	QTÉ PQT
16-0002	Capuchon de valve de biopsie – Olympus®	Bleu	100
16-0004	Capuchon de valve de biopsie – Pentax®	Rouge	100
16-0022	Capuchon de valve de biopsie – Olympus® et Fujinon®	Bleu pâle	100
16-0044	Capuchon de valve de biopsie – Pentax®	Rose	100

ENDOSCOPIE CAPSULAIRE

À usage unique

CapsoCam Plus®

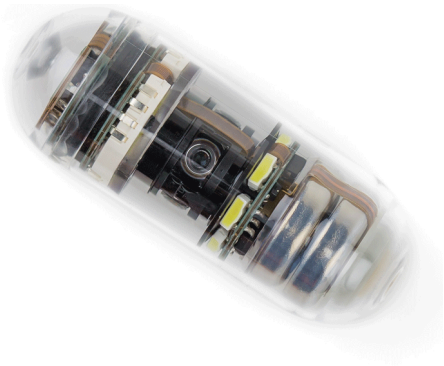

Conçue pour améliorer les capacités diagnostiques en offrant une vue latérale panoramique complète à 360° de la muqueuse de l'intestin grêle.

Aucun enregistreur de données externe.

- Confort accru pour le patient
- Utilisation sécuritaire chez les patients porteurs de stimulateurs cardiaques ou d'autres implants électroniques
- Aucun risque de perte de données chez les patients ayant un IMC élevé
- Idéale pour les patients en régions éloignées

Vue complète à 360°



Image CapsoCam Plus de la muqueuse de l'intestin grêle vue à 1152 x 212 pixels.



Consultez les résultats en tout temps, de partout, avec CapsoCloud™



CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
CAPSOCAM-PLUS	Endoscope capsulaire CapsoCam Plus® et trousse de récupération, chacun	1
CDAS	Accès aux données de la capsule CapsoCam Plus	1


800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

PINCES DE RÉCUPÉRATION – SPÉCIALITÉ

À usage unique

Dispositif de récupération à boucle


Poignée unique à ressort

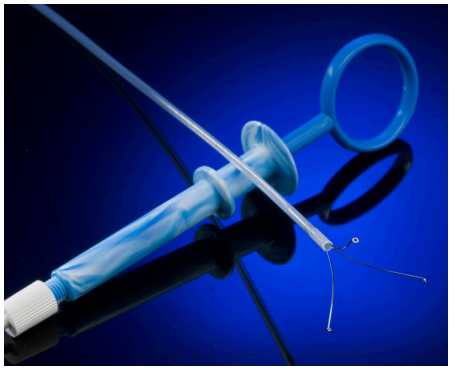

CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE D'OUVERTURE	CANAL MIN.	LONGUEUR	QTÉ PQT
5030S	3 griffes en boucle	2,5 cm	≥ 2,8 mm	220 cm	5

Filets de récupération

VedGrasper

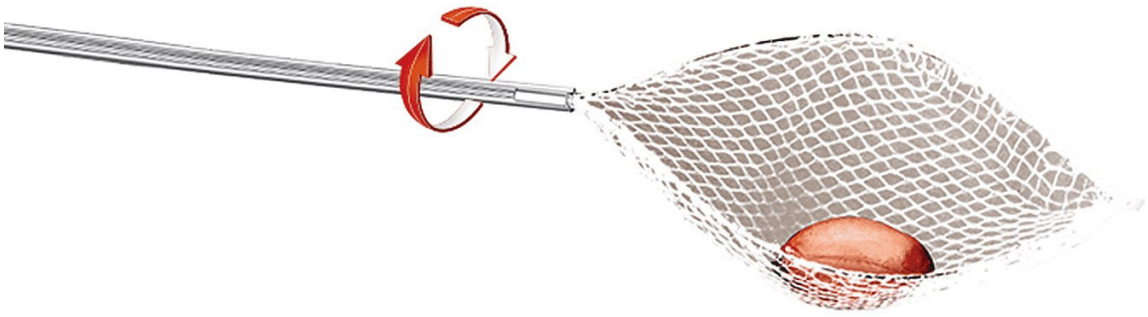

CODE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	LONGUEUR	CANAL D'ENDOSCOPE	TAILLE DU FILET	ROTATION	QTÉ PQT
VDK-FG-25-230-C1	2,5 mm	2300 mm	≥ 2,8 mm	20 x 50 mm	Standard	10
VDK-FG-25-230-C2	2,5 mm	2300 mm	≥ 2,8 mm	25 x 55 mm	Standard	10
VDK-FG-25-230-C3	2,5 mm	2300 mm	≥ 2,8 mm	30 x 60 mm	Standard	10
VDK-FG-25-230-C4	2,5 mm	2300 mm	≥ 2,8 mm	40 x 75 mm	Standard	10
VDK-FG-25-230-C5	2,5 mm	2300 mm	≥ 2,8 mm	40 x 65 mm	Standard	10
VDK-FG-25-230-C1R	2,5 mm	2300 mm	≥ 2,8 mm	20 x 50 mm	Synchrone	10
VDK-FG-25-230-C2R	2,5 mm	2300 mm	≥ 2,8 mm	25 x 55 mm	Synchrone	10
VDK-FG-25-230-C3R	2,5 mm	2300 mm	≥ 2,8 mm	30 x 60 mm	Synchrone	10
VDK-FG-25-230-C4R	2,5 mm	2300 mm	≥ 2,8 mm	40 x 75 mm	Synchrone	10

PINCES DE RÉCUPÉRATION – SPÉCIALITÉ

À usage unique

Pinces de préhension

Diversatek™ EndoGrip



Rotation à 360° !


CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE DE LA GAINE	CANAL MIN.	LONGUEUR	QTÉ PQT
1177-01	Pince dents de rat avec mâchoires alligator	2.3 mm	≥ 2.8 mm	230 cm	5


*D'autres modèles peuvent être disponibles. Veuillez communiquer avec votre représentant pour plus de détails.

ANSES DE POLYPECTOMIE

À usage unique – à utiliser avec les cordons actifs Olympus

Chaudes

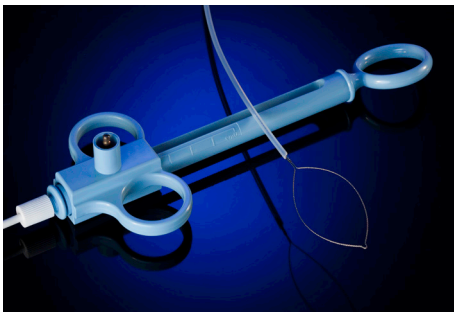

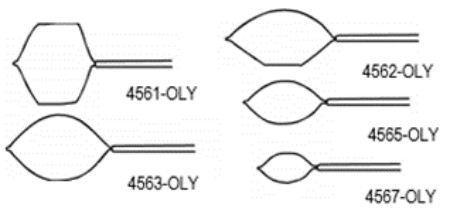

CODE	DESCRIPTION	TAILLE DE LA BOUCLE	DIAMÈTRE DE LA GAINE	LONGUEUR	QTÉ PQT
4561-OLY	Hexagonale	4,0 x 3,0 cm	2,3 mm	220 cm	5
4562-OLY	Croissante	5,0 x 2,5 cm	2,3 mm	220 cm	5
4563-OLY	Standard ovale	5,0 x 2,5 cm	2,3 mm	220 cm	5
4564-OLY	Maxi-Ovale	5,5 x 3,5 cm	2,3 mm	220 cm	5
4565-OLY	Mini-Ovale	3,5 x 2,0 cm	2,3 mm	220 cm	5
4567-OLY	Micro-Ovale	2,5 x 1,5 cm	2,3 mm	220 cm	5
4573-OLY	Standard ovale	5,0 x 2,5 cm	2,3 mm	220 cm	5

ANSES DE POLYPECTOMIE

HYBRIDES, FROIDES ET CHAUDES



Hybrides

CODE	DESCRIPTION	TAILLE DE LA BOUCLE	QTÉ PQT
AG-5075-241023	Oval, orientable	10 mm	10
AG-5075-241523	Oval, orientable	15 mm	10
AG-5076-241023	Bouclier, orientable	10 mm	10
AG-5076-241523	Bouclier, orientable	15 mm	10
AG-5078-241523	Rond, orientable	15 mm	10

Froides


CODE	DESCRIPTION	TAILLE DE LA BOUCLE	QTÉ PQT
AG-5335-241023	Oval, orientable	10 mm	10
AG-5335-241523	Oval, orientable	15 mm	10
AG-5336-241023	Bouclier, orientable	10 mm	10
AG-5336-241523	Bouclier, orientable	15 mm	10

Chaudes

CODE	DESCRIPTION	TAILLE DE LA BOUCLE	QTÉ PQT
AG-5075-242523	Oval, orientable	25 mm	10
AG-5075-243223	Oval, orientable	32 mm	10
AG-5078-242523	Rond, orientable	25 mm	10


ANSES DE POLYPECTOMIE

À usage unique – à utiliser avec poignée Smart

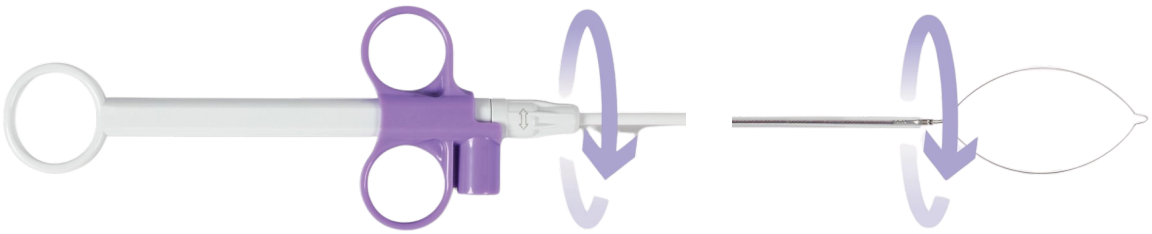

Chaud / Froid

CODE	DESCRIPTION	TAILLE DE LA BOUCLE	QTÉ PQT
1180-01	Ovale	10 mm	10
1180-02	Ovale	15 mm	10
1180-03	Ovale	25 mm	10
1180-04	Ovale	32 mm	10
1180-10	Hexagonale	15 mm	10
1180-11	Hexagonale 3-en-1	10/15/25 mm	10

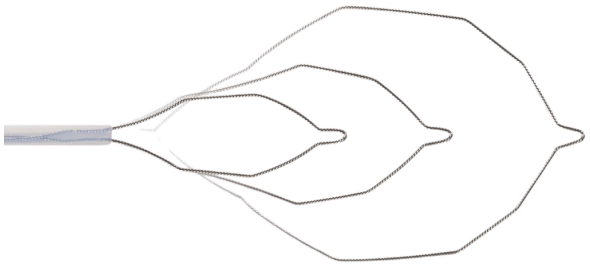

Froid

CODE	DESCRIPTION	TAILLE DE LA BOUCLE	QTÉ PQT
1180-12	Ovale	10 mm	10
1180-13	Ovale	15 mm	10
1180-14	Hexagonale	10 mm	10
1180-15	Hexagonale	15 mm	10


800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

AIGUILLES D'INJECTION

À usage unique

Aiguilles d'injection Posi-Stop

La pointe de l'aiguille et le mécanisme de verrouillage préviennent les perforations potentielles du canal de l'endoscope

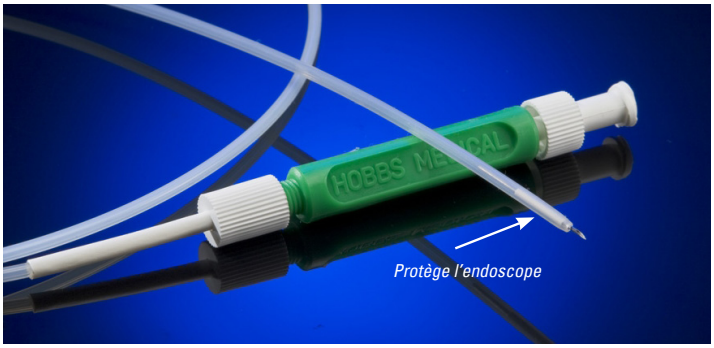

CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE DE LA GAINE	LONGUEUR	QTÉ PQT
LONGUEUR GASTROSCOPIE				
4702	23 gauge/ 5,0 mm	1,8 mm	200 cm	1
4704	25 gauge/ 5,0 mm	1,8 mm	200 cm	1
4706	23 gauge/ 5,0 mm	2,3 mm	200 cm	1
4708	25 gauge/ 5,0 mm	2,3 mm	200 cm	1
4714	25 gauge/ 4,0 mm	1,8 mm	200 cm	1
4718	25 gauge/ 4,0 mm	2,3 mm	200 cm	1
LONGUEUR COLONOSCOPIE / ENTÉROSCOPIE				
4720	23 gauge/ 5,0 mm	2,3 mm	260 cm	1
4721	23 gauge/ 4,0 mm	2,3 mm	260 cm	1
4722	25 gauge/ 5,0 mm	2,3 mm	260 cm	1
4723	25 gauge/ 4,0 mm	2,3 mm	260 cm	1

Aiguilles d'injection EndoTNeedle

Gaine en acier inoxydable




CODE	DESCRIPTION	CANAL MIN.	DIAMÈTRE DE LA POINTE	LONGUEUR	QTÉ PQT
ET1301	23 gauge/ 4,0 mm	2,8 mm	2,5 mm	230 cm	10
ET1303	25 gauge/ 5,0 mm	2,8 mm	2,5 mm	230 cm	10
ET1321	23 gauge/ 4,0 mm	2,8 mm	2,5 mm	230 cm	10
ET1323	23 gauge/ 5,0 mm	2,8 mm	2,5 mm	230 cm	10

AIGUILLES D'INJECTION

À usage unique

Aiguille de sclérothérapie jetable

- Aiguille distale en acier inoxydable avec tube en plastique
- Différents calibres, longueurs d'aiguille et diamètres de tube

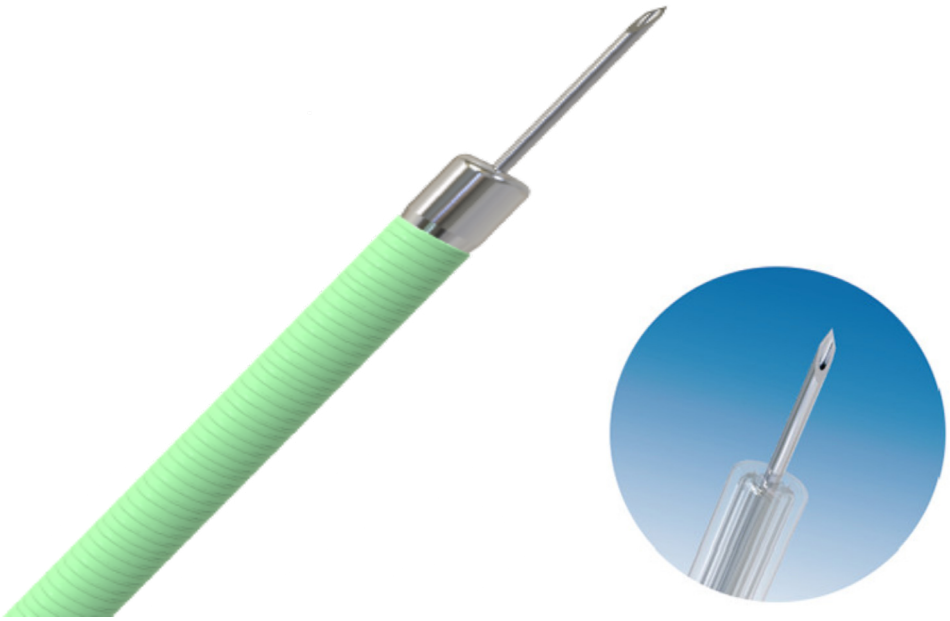

CODE	LONGUEUR UTILE	D.E. DE LA GAINE	LONGUEUR DE L'AIGUILLE	CALIBRE (GAUGE)	QTÉ PQT
LONGUEUR GASTROSCOPIE					
AG-5081-2423-2104	2300 mm	2,4 mm	4 mm	21	10
AG-5081-2423-2106	2300 mm	2,4 mm	6 mm	21	10
AG-5082-2423-2304	2300 mm	2,4 mm	4 mm	23	10
AG-5082-2423-2306	2300 mm	2,4 mm	6 mm	23	10
AG-5083-2423-2504	2300 mm	2,4 mm	4 mm	25	10
AG-5083-2423-2506	2300 mm	2,4 mm	6 mm	25	10

HÉMOCLIP ENDOSCOPIQUE

À usage unique

Clip hémostatique

Clip hémostatique repositionnable avec un déploiement précis et tactile ainsi qu'une rotation à 360° pour un contrôle optimal



CODE	LONGUEUR UTILE	CANAL MIN.	D.E. MAX. DU CLIP	OUVERTURE MAX. DU CLIP	ANGLE DE LA MÂCHOIRE	QTÉ PQT
AG-5104-2300-090	2300 mm	2,8 mm	2,6	11 mm	090	10
AG-5104-2300-135	2300 mm	2,8 mm	2,6	11 mm	135	10
AG-5108-2300-090-9	2300 mm	2,8 mm	2,6	9 mm	090	10
AG-5108-2300-135-9	2300 mm	2,8 mm	2,6	9 mm	135	10
AG-51018-2300-090-13	2300 mm	2,8 mm	2,6	13 mm	090	10
AG-51018-2300-135-13	2300 mm	2,8 mm	2,6	13 mm	135	10
AG-51044-2300-090-16	2300 mm	2,8 mm	2,6	16 mm	090	10
AG-51044-2300-135-16	2300 mm	2,8 mm	2,6	16 mm	135	10

PINCES À BIOPSIE

À usage unique





Cup lisse, complète, avec bord de coupe tranchant



Avec cup pivotante, une biopsie verticale peut également être effectuée pour l'œsophage, la grande courbure de l'estomac et d'autres zones

Cup grande capacité avec conception perforée pour augmenter le volume d'échantillonnage

CODE	TYPE DE MÂCHOIRE	D.E. DE LA MÂCHOIRE.	CANAL MIN.	LONGUEUR	QTÉ PQT
AG-50121-2323	Sans pointe, bord lisse, non pivotante	2,3 mm	≥ 2,8 mm	230 cm	10
AG-50122-2323	Avec pointe, bord lisse, non pivotante	2,3 mm	≥ 2,8 mm	230 cm	10
AG-50123-2323	Sans pointe, bord dentelé, non pivotante	2,3 mm	≥ 2,8 mm	230 cm	10
AG-50124-2323	Avec pointe, bord dentelé, non pivotante	2,3 mm	≥ 2,8 mm	230 cm	10
AG-5021-2316	Sans pointe, bord lisse, pivotante	2,3 mm	≥ 2,8 mm	160 cm	10
AG-5022-2316	Avec pointe, bord lisse, pivotante	2,3 mm	≥ 2,8 mm	160 cm	10
AG-5023-2316	Sans pointe, bord dentelé, pivotante	2,3 mm	≥ 2,8 mm	160 cm	10
AG-5024-2316	Avec pointe, bord dentelé, pivotante	2,3 mm	≥ 2,8 mm	160 cm	10


PINCES JUMBO

À usage unique





Rotative



Visibilité améliorée avec repère

Cup grande capacité avec forme ovale et bord dentelé


CODE	TYPE DE MÂCHOIRE	D.E. DE LA MÂCHOIRE	CANAL MIN.	LONGUEUR	QTÉ PQT
AG-5029-2823	Sans pointe, pivotante, bord lisse	2,8 mm	≥ 3,2 mm	230 cm	10
AG-50210-2823	Avec pointe, pivotante, bord lisse	2,8 mm	≥ 3,2 mm	230 cm	10
AG-50211-2823	Sans pointe, pivotante, avec dents alligator	2,8 mm	≥ 3,2 mm	230 cm	10
AG-50212-2823	Avec pointe, pivotante, avec dents alligator	2,8 mm	≥ 3,2 mm	230 cm	10
AG-50213-2823	Sans pointe, non pivotante, bord lisse, rotative	2,8 mm	≥ 3,2 mm	230 cm	10
AG-50214-2823	Avec pointe, non pivotante, bord lisse, rotative	2,8 mm	≥ 3,2 mm	230 cm	10
AG-50215-2823	Sans pointe, non pivotante, avec dents alligator, rotative	2,8 mm	≥ 3,2 mm	230 cm	10
AG-50216-2823	Avec pointe, non pivotante, avec dents alligator, rotative	2,8 mm	≥ 3,2 mm	230 cm	10

BROSSES DE CYTOLOGIE ET DE MICROBIOLOGIE

À usage unique

Conception de brosse inversée

Brosse conçue pour un rendement maximal avec un minimum de résidus laissés dans la gaine

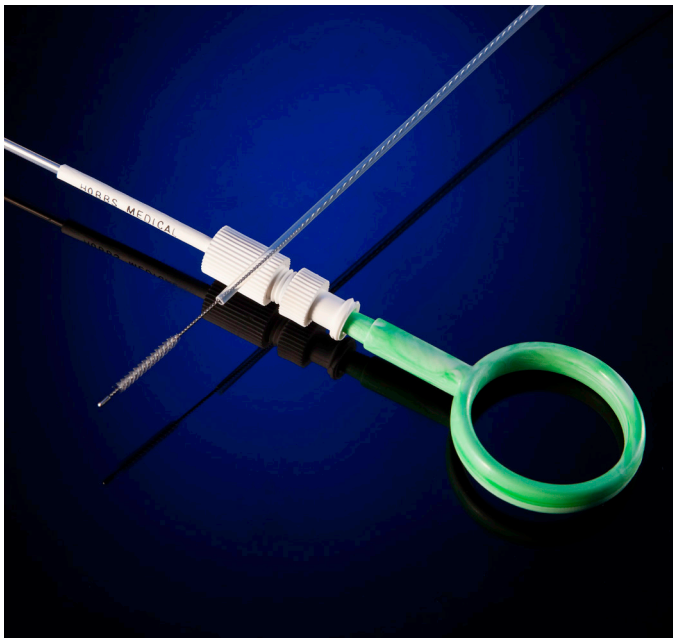


CODE	DIAMÈTRE DE LA BROSSE	DIAMÈTRE DE LA GAINE	LONGUEUR	QTÉ PQT
4104	3,0 mm	1,7 mm	200 cm	10
4106	3,0 mm	1,7 mm	230 cm	10
4108	3,0 mm	2,3 mm	160 cm	10
4110	3,0 mm	2,3 mm	200 cm	10
4112	3,0 mm	2,3 mm	260 cm	10

800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

BROSSES DE CYTOLOGIE ET DE MICROBIOLOGIE

À usage unique

Conception de brosse cylindrique et en « U »

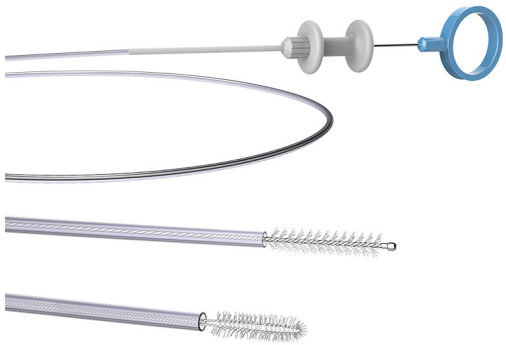


B = brosse en « U »
C = brosse droite

CODE	D.E. DU CATHÉTER	CANAL D'ENDO-SCOPE	LONGUEUR UTILE	D.E. DE LA BROSSE	LONGUEUR DE LA BROSSE	QTÉ PQT
VDK-BC-23-230-B	2,3 mm	≥ 2,8 mm	2300 mm	2,85 mm	8 mm	10
VDK-BC-23-160-B	2,3 mm	≥ 2,8 mm	1600 mm	2,85 mm	8 mm	10
VDK-BC-23-105-B	2,3 mm	≥ 2,8 mm	1050 mm	2,85 mm	8 mm	10
VDK-BC-18-180-C	1,8 mm	≥ 2,0 mm	1800 mm	3 mm	10 mm	10
VDK-BC-18-160-C	1,8 mm	≥ 2,0 mm	1600 mm	3 mm	10 mm	10
VDK-BC-23-230-C	2,3 mm	≥ 2,8 mm	2300 mm	3,5 mm	8 mm	10
VDK-BC-23-105-C	2,3 mm	≥ 2,8 mm	1050 mm	3,5 mm	8 mm	10
VDK-BC-23-160-C	2,3 mm	≥ 2,8 mm	1600 mm	3,5 mm	8 mm	10
VDK-BC-23-180-C	2,3 mm	≥ 2,8 mm	1800 mm	3,5 mm	8 mm	10

Brosses De Microbiologie

- La conception prévient la contamination de la brosse
- La poignée à ressort permet l'étanchéité automatique de l'extrémité distale
- Le mécanisme de verrouillage de la poignée permet une position ouverte de la brosse
- La configuration de la brosse augmente le rendement de l'échantillon

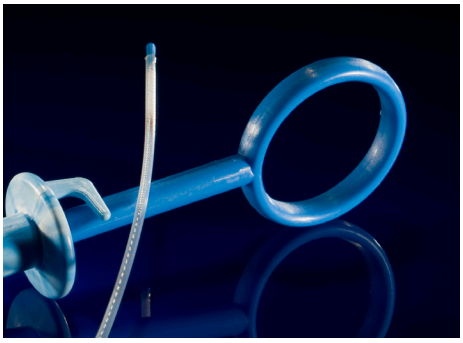

CODE	DIAMÈTRE DE LA BROSSE	DIAMÈTRE DE LA GAINE	LONGUEUR	QTÉ PQT
4320	2,0 mm	1,7 mm	100 cm	5
4352	2,0 mm	1,7 mm	220 cm	5

DILATATEURS À BALLONNET

Fil guide fixe – à usage unique

Dilatateur à 3 paliers

Pré-lubrifié pour une insertion et un retrait facilités



CODE	DIAMÈTRE EXTERNE GONFLÉ	LONGUEUR DU BALLONNET	CANAL MIN.	LONGUEUR UTILE	QTÉ PQT
1204-08	6-7-8 / 18-21-24 FR	8 cm	2,8 mm	180 cm	1
1204-10	8-9-10 / 24-27-30 FR	8 cm	2,8 mm	180 cm	1
1204-12	10-11-12/ 30-33-36 FR	8 cm	2,8 mm	180 cm	1
1204-15	12-13.5-15 / 36-40.5-45	8 cm	2,8 mm	180 cm	1
1204-18	15-16.5-18/ 45-49.5-54	8 cm	2,8 mm	180 cm	1
1204-20	18-19-20/ 54-57-60	8 cm	2,8 mm	180 cm	1

800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

DILATATEURS À BALLONNET

Sur fil guide – à usage unique

Dilatateur à 3 paliers

- Indiqué pour les sténoses de l'ensemble du tractus gastro-intestinal
- Le mécanisme de verrouillage assure le positionnement du fil guide
- Guidé par fil



CODE	DIAMÈTRE	TAILLE (FR)	LONGUEUR DU BALLONNET	PRESSION (ATM)	LONGUEUR UTILE	QTÉ PQT
1205-08	6 - 7 - 8 mm	18 - 21 - 24 FR	5,5 cm	4 - 6 - 8	240 cm	1
1205-10	8 - 9 - 10 mm	24 - 27 - 30 FR	5,5 cm	4 - 6 - 8	240 cm	1
1205-12	10 - 11 - 12 mm	30 - 33 - 36 FR	5,5 cm	2 - 4 - 6	240 cm	1
2305-15	12 - 13.5 - 15 mm	36 - 40.5 - 45 FR	5,5 cm	2 - 4 - 6	240 cm	1
1205-18	15 - 16.5 - 18 mm	45 - 49.5 - 54 FR	5,5 cm	2 - 4 - 6	240 cm	1
1205-20	18 - 19 -20 mm	54 - 57 - 60 FR	5,5 cm	2 - 4 - 6	240 cm	1

STENTS BILIAIRES

À usage unique

Biocompatible – sécuritaire pour l'IRM



CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	LONGUEUR UTILE	QTÉ PQT
6102	Stent pigtail	7 FR	4 cm	240 cm	1
6103	Stent pigtail	7 FR	7 cm	240 cm	1
6104	Stent pigtail	7 FR	10 cm	240 cm	1
6106	Stent pigtail	10 FR	4 cm	240 cm	1
6107	Stent pigtail	10 FR	7 cm	240 cm	1


Remarque : également disponibles en ensembles avec fil guide et cathéter pousseur.

STENTS PANCRÉATIQUES FLEXI

À usage unique

Stents Freeman

- Compatibles avec votre système d'échange actuel
- Biocompatibles – sécuritaires pour l'IRM
- Conçus à court terme pour réduire le risque de traumatisme du canal
- Ailettes de rétention internes et externes pour un positionnement facilité

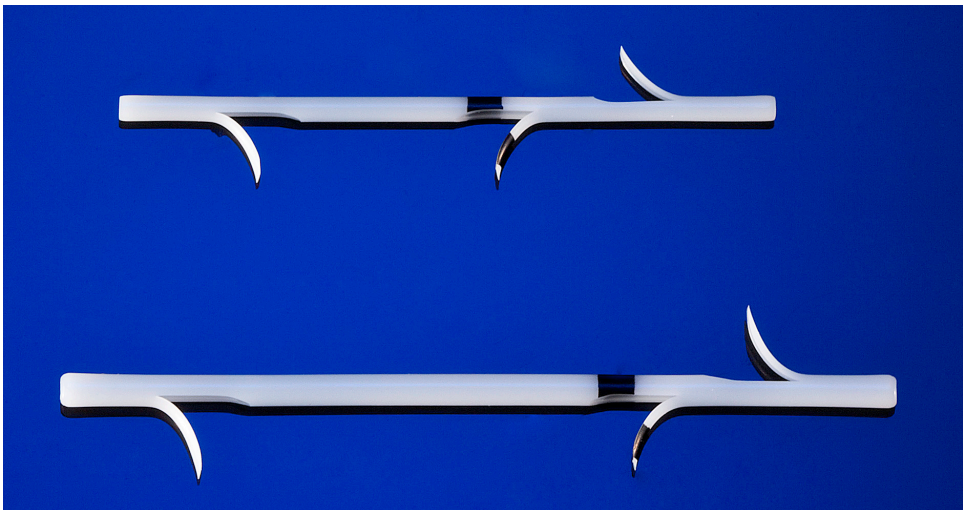

*Également disponibles en ensembles avec cathéter pousseur

Style droit


CODE	DIAMÈTRE DU STENT	LONGUEUR DU STENT	COMPATIBILITÉ FIL GUIDE	QTÉ PQT
6341	4 FR	2 cm	.025″	1
6342	4 FR	3 cm	.025″	1
6351	5 FR	2 cm	.025″	1
6352	5 FR	3 cm	.025″	1

Cathéters Pousseurs / Guides – Stents Pancréatiques et Biliaires

CODE	DESCRIPTION	CANAL MIN.	LONGUEUR	QTÉ PQT
6138	Cathéter pousseur pour stents 3 FR	2.8 mm	170 cm	1
6136	Cathéter pousseur pour stents 4 et 5 FR	2.8 mm	170 cm	1
6132	Cathéter pousseur pour stents 7 FR	2.8 mm	170 cm	1
6134	Cathéter pousseur pour stents 10 FR	2.8 mm	170 cm	1

STENTS PANCRÉATIQUES FLEXI

À usage unique

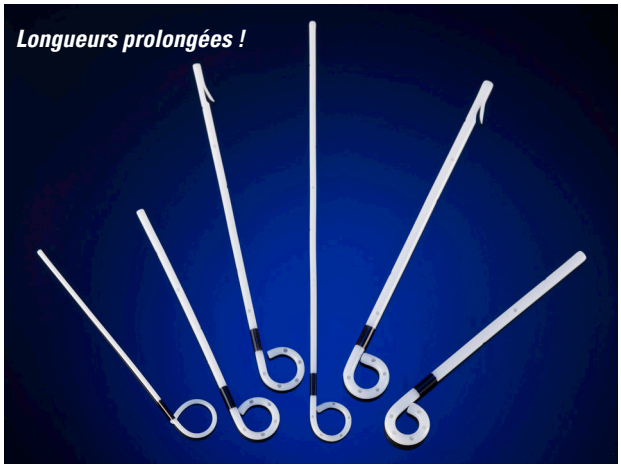

Stents pigtail

*Également disponibles en ensembles avec cathéter pousseur

CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	COMPATIBILITÉ FIL GUIDE	QTÉ PQT
6532	Sans ailette	3 FR	5 cm	.021″	1
6541	Avec ailette	4 FR	3 cm	.025″	1
6542	Avec ailette	4 FR	5 cm	.025″	1
6544	Sans ailette	4 FR	7 cm	.025″	1
6545	Sans ailette	4 FR	9 cm	.025″	1
6546	Sans ailette	4 FR	11 cm	.025″	1
6551	Avec ailette	5 FR	3 cm	.035″	1
6552	Avec ailette	5 FR	5 cm	.035″	1
6554	Avec ailette	5 FR	7 cm	.035″	1
6555	Avec ailette	5 FR	9 cm	.035″	1
6561	Avec ailette	5 FR	3 cm	.035″	1
6562	Sans ailette	5 FR	5 cm	.035″	1
6564	Sans ailette	5 FR	7 cm	.035″	1
6565	Sans ailette	5 FR	9 cm	.035″	1
6566	Sans ailette	5 FR	12 cm	.035″	1
6567	Sans ailette	5 FR	15 cm	.035″	1
6571	Avec ailette	7 FR	3 cm	.035″	1
6572	Avec ailette	7 FR	5 cm	.035″	1
6574	Avec ailette	7 FR	7 cm	.035″	1
6575	Avec ailette	7 FR	9 cm	.035″	1
6576	Avec ailette	7 FR	11 cm	.035″	1
6582	Sans ailette	7 FR	5 cm	.035″	1
6584	Sans ailette	7 FR	7 cm	.035″	1
6585	Sans ailette	7 FR	9 cm	.035″	1

CATHÉTERS DE PULVÉRISATION

À usage unique

Cathéters de pulvérisation

Jet de pulvérisation uniforme à 360°



CODE	DIAMÈTRE DE LA GAINE	LONGUEUR	QTÉ PQT
2190	2,6 mm	260 cm	5

DISPOSITIFS ET ACCESSOIRES PULMONAIRES

INHALOTHÉRAPEUTES – ACCESSOIRES ENDOTRACHÉAUX **29**

Protecteurs Buccaux Endotrachéaux 29

Baby Tape Plus™ 30

StabilTube™ 30

LockTite™ 30

PROTECTEURS BUCCAUX **31**

DISPOSITIFS DE RÉCUPÉRATION **32**

Filets 32

Dents de rat 33

PINCES À BIOPSIE **34**

Bronch 34


Mini Pinces à Biopsie 35

BROSSES DE CYTOLOGIE ET DE MICROBIOLOGIE **36**

PROTECTEURS BUCCAUX ENDOTRACHÉAUX

À usage unique

- Solutions de protecteurs buccaux pour la protection des tubes endotrachéaux
- Préviennent l'occlusion du tube lors de la morsure; protègent contre la rupture du ballon pilote
- Réduisent les coûts associés à la réintubation
- Sans latex

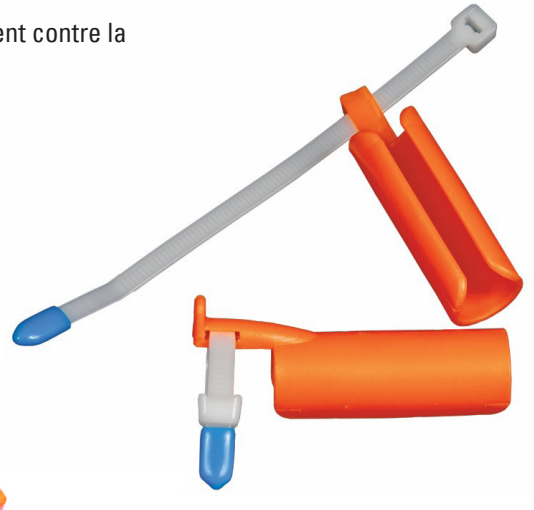

11160




11170

CODE	DESCRIPTION	TAILLE DU TUBE ENDOTRACHÉAL	QTÉ PQT
11160	Protecteur buccal universel	6 mm to 9,5 mm	50
11170	Protecteur buccal universel pédiatrique	4 mm to 6 mm	50

BABY TAPE PLUS™

À usage unique



CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
25390	Baby Tape Plus	100/boîte
25395	Baby Tape Plus	50/boîte

STABILTUBE™

À usage unique






CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
11060	StabilTube	40/boîte
11065	StabilTube	20/boîte

LOCKTITE™

À usage unique

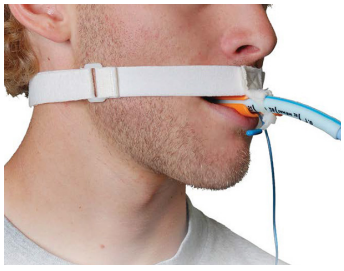



CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
11090	LockTite	50/boîte

PROTECTEURS BUCCAUX

À usage unique



KS02-9016



KS02-9016N




KS02-9019



KS02-9020



KS02-9021

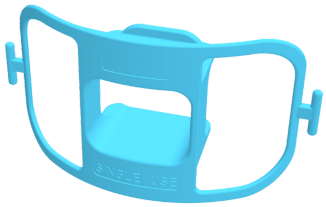

KS02-9022


CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	QTÉ PQT
KS02-9016	Orange avec sangle	16 mm / 48 FR	100
KS02-9016N	Orange sans sangle	16 mm / 48 FR	100
KS02-9019	Bleu sans sangle	18 mm / 54 FR	100
KS02-9020	Bleu avec sangle	20 mm / 60 FR	25
KS02-9021	Adulte, rond, coussin de confort	27 mm x 21 mm / 82 FR x 64 FR	50
KS02-9022	Adulte, carré, coussin de confort	27 mm x 22 mm / 82 FR × 67 FR	50

DISPOSITIFS DE RÉCUPÉRATION

À usage unique

Filets de récupération

VedGrasper

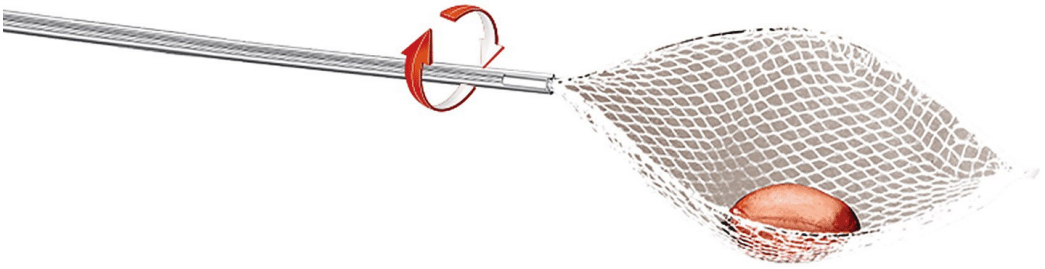

CODE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	LONGUEUR	CANAL D'ENDOSCOPE	TAILLE DU FILET	ROTATION	QTÉ PQT
VDK-FG-18-120-C1	1,8 mm	1200 mm	≥ 2,0 mm	20 x 50 mm	Standard	10
VDK-FG-18-120-C2	1,8 mm	1200 mm	≥ 2,0 mm	25 x 55 mm	Standard	10
VDK-FG-18-120-C3	1,8 mm	1200 mm	≥ 2,0 mm	30 x 60 mm	Standard	10
VDK-FG-18-160-C1	1,8 mm	1600 mm	≥ 2,0 mm	20 x 50 mm	Standard	10
VDK-FG-18-160-C2	1,8 mm	1600 mm	≥ 2,0 mm	25 x 55 mm	Standard	10
VDK-FG-18-160-C3	1,8 mm	1600 mm	≥ 2,0 mm	30 x 60 mm	Standard	10

PINCES DE PRÉHENSION

À usage unique

Conception à quatre articulations, force de préhension accrue du produit




CODE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	LONGUEUR	CANAL D'ENDOSCOPE	FORME DE LA MÂCHOIRE	TYPE DE MÂCHOIRE	QTÉ PQT
AG-5032-1823	1,8 mm	2300 mm	≥ 2,0 mm	Alligator	Dents de rat	10


PINCES À BIOPSIE

À usage unique

- Conception standard de cup offrant une capacité d'échantillonnage adéquate avec un minimum de traumatisme tissulaire
- Plusieurs modèles disponibles sur demande

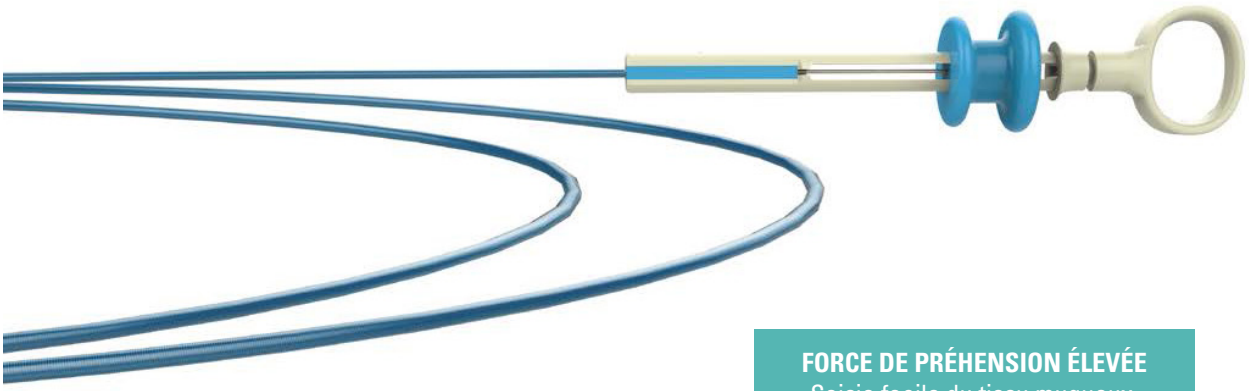

FORCE DE PRÉHENSION ÉLEVÉE
Saisie facile du tissu muqueux, réduisant les risques de déchirure et de saignement

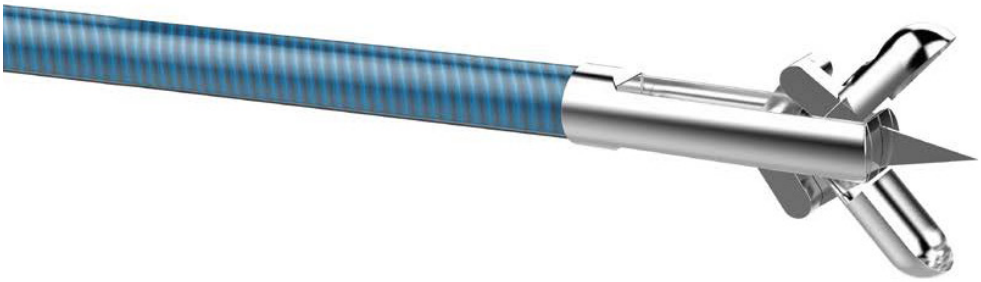



CODE	TYPE DE MÂCHOIRE	D.E. DE LA MÂCHOIRE	CANAL MIN.	LONGUEUR	QTÉ PQT
VDK-FB-18-105-O-P-A1	Sans pointe, revêtue, avec dents alligator	1,8 mm	≥ 2,0 mm	105 cm	10
VDK-FB-18-105-O-P-B1	Sans pointe, revêtue	1,8 mm	≥ 2,0 mm	105 cm	10
VDK-FB-18-105-W-P-B1	Avec pointe, revêtue	1,8 mm	≥ 2,0 mm	105 cm	10
VDK-FB-18-160-O-P-B1	Sans pointe, revêtue	1,8 mm	≥ 2,0 mm	160 cm	10
VDK-FB-18-105-O-O-B1	Sans pointe, non revêtue	1,8 mm	≥ 2,0 mm	105 cm	10
VDK-FB-18-105-W-O-B1	Avec pointe, non revêtue	1,8 mm	≥ 2,0 mm	105 cm	10

800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

MINI PINCES À BIOPSIE

À usage unique

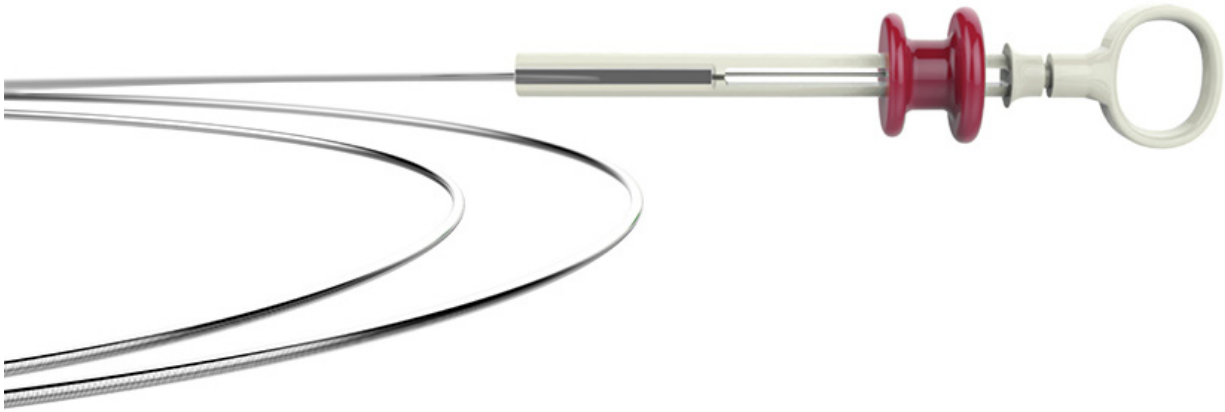

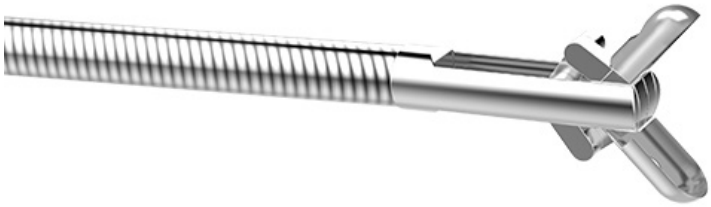


CODE	TYPE DE MÂCHOIRE	D.E. DE LA MÂCHOIRE	CANAL MIN.	LONGUEUR	QTÉ PQT
VDK-MFB-80-B1	Sans pointe, non revêtue	1,0 mm	≥ 1,2 mm	800 mm	10
VDK-MFB-120-B1	Sans pointe, non revêtue	1,0 mm	≥ 1,2 mm	1200 mm	10
VDK-MFB-180-B1	Sans pointe, non revêtue	1,0 mm	≥ 1,2 mm	1800 mm	10
VDK-MFB-230-B1	Sans pointe, non revêtue	1,0 mm	≥ 1,2 mm	2300 mm	10
VDK-MFB-260-B1	Sans pointe, non revêtue	1,0 mm	≥ 1,2 mm	2600 mm	10
VDK-MFB-290-B1	Sans pointe, non revêtue	1,0 mm	≥ 1,2 mm	2900 mm	10

BROSSES DE CYTOLOGIE ET DE MICROBIOLOGIE

À usage unique

Conception de brosse inversée

Brosse conçue pour un rendement maximal avec un minimum de résidus laissés dans la gaine.

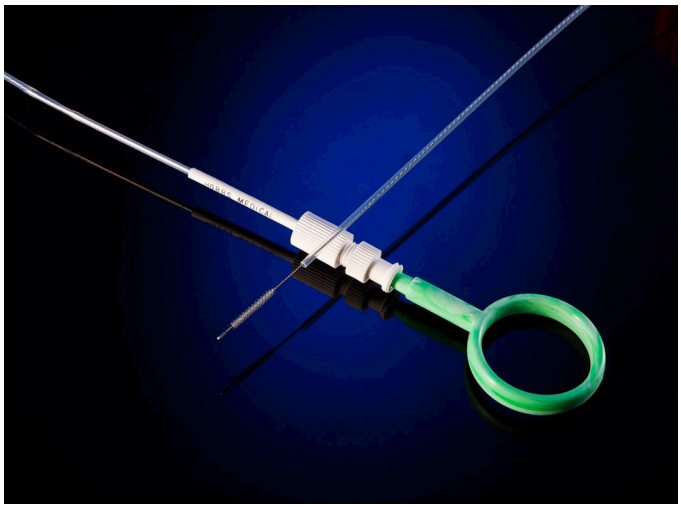


CODE	DIAMÈTRE DE LA BROSSE	DIAMÈTRE DE LA GAINE	LONGUEUR	QTÉ PQT
4202	1,0 mm	1,7 mm	120 cm	10
4204	2,0 mm	1,7 mm	120 cm	10
4206	3,0 mm	1,7 mm	120 cm	10
4102	3,0 mm	1,7 mm	160 cm	10

800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

BROSSES DE CYTOLOGIE ET DE MICROBIOLOGIE

À usage unique

Conception de brosse cylindrique et en « U »

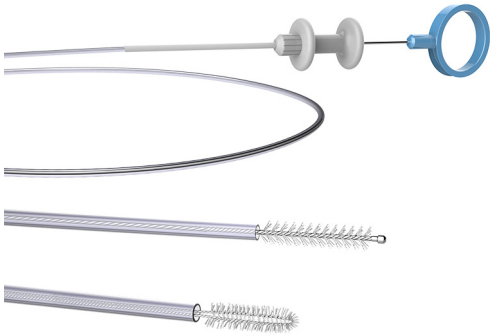


A = Tube protecteur anti-pollution
B = Brosse en « U »
C = Brosse droite

CODE	D.E. DU CATHÉTER	CANAL D'ENDO-SCOPE	LONGUEUR UTILE	D.E. DE LA BROSSE	LONGUEUR DE LA BROSSE	QTÉ PQT
VDK-BC-18-120-A	1,8 mm	≥ 2,0 mm	1200 mm	2 mm	10 mm	10
VDK-BC-18-105-A	1,8 mm	≥ 2,0 mm	1050 mm	2 mm	10 mm	10
VDK-BC-18-105-B	1,8 mm	≥ 2,0 mm	1050 mm	2 mm	10 mm	10
VDK-BC-18-120-B	1,8 mm	≥ 2,0 mm	1200 mm	2 mm	10 mm	10
VDK-BC-18-105-C	1,8 mm	≥ 2,0 mm	1050 mm	3 mm	10 mm	10
VDK-BC-18-120-C	1,8 mm	≥ 2,0 mm	1200 mm	3 mm	10 mm	10
VDK-BC-18-115-C	1,8 mm	≥ 2,0 mm	1150 mm	3 mm	10 mm	10
VDK-BC-18-110-C	1,8 mm	≥ 2,0 mm	1100 mm	3 mm	10 mm	10
VDK-BC-18-110-C-2	1,8 mm	≥ 2,0 mm	1100 mm	2 mm	10 mm	10

Brosses De Microbiologie

- La conception prévient la contamination de la brosse
- La poignée à ressort permet l'étanchéité automatique de l'extrémité distale
- Le mécanisme de verrouillage de la poignée permet une position ouverte de la brosse
- La configuration de la brosse augmente le rendement de l'échantillon

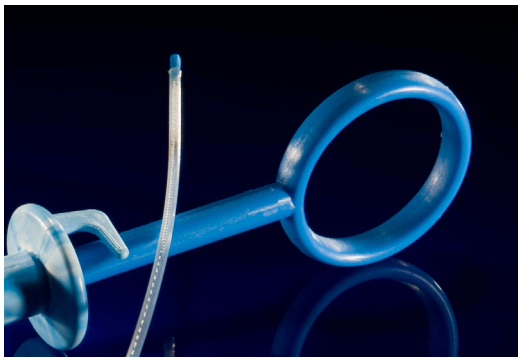


CODE	DIAMÈTRE DE LA BROSSE	DIAMÈTRE DE LA GAINE	LONGUEUR	QTÉ PQT
4310	1,0 mm	1,7 mm	100 cm	5

ENDO
KEIR SURGICAL

Keir Surgical offre un portefeuille complet de solutions couvrant les outils de diagnostic et thérapeutiques en endoscopie, la technologie d'endoscopie capsulaire ainsi que les produits de retraitement des endoscopes. En plus des produits présentés dans ce catalogue, nous offrons également :

» Pinces à biopsie à aiguille fine et aiguilles d'aspiration à aiguille fine pour l'EUS et l'EBUS
» Endoscopes à usage unique incluant urétéroscopes, cystoscopes, rhinolaryngoscopes, bronchoscopes et vidéolaryngoscopes
» Autres longueurs, dimensions et variantes de dispositifs

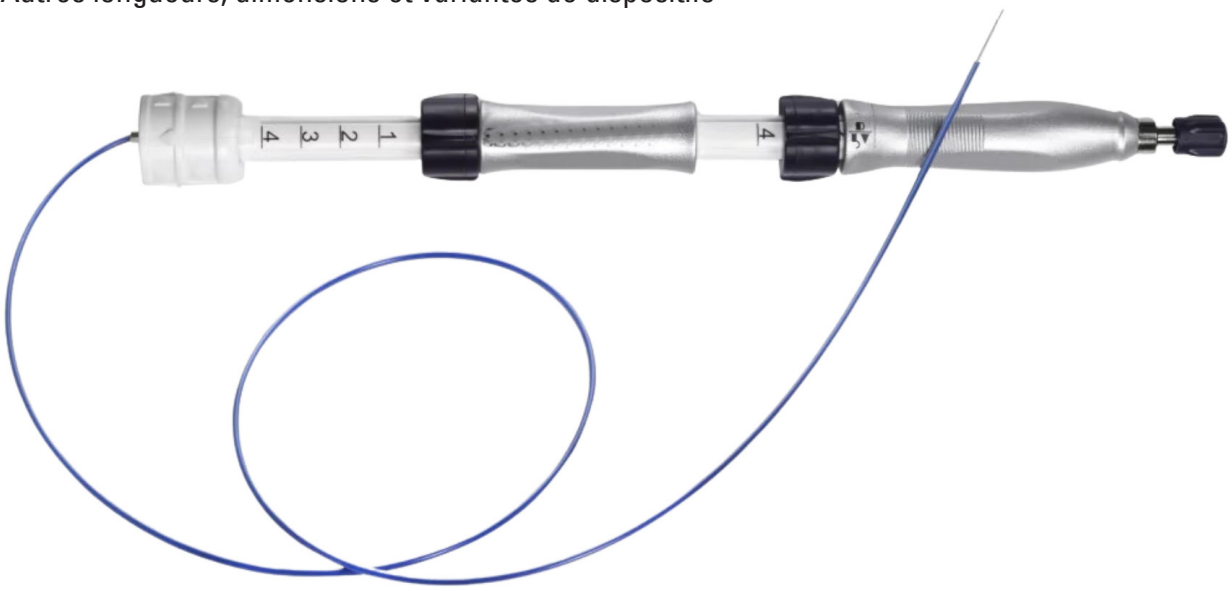

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?

Ce catalogue présente plusieurs de nos produits les plus demandés, mais nous offrons également d'autres gammes de produits non présentées ici et poursuivons l'élargissement de notre portefeuille.

Nous sommes en mesure de nous approvisionner pour les produits dont vous avez besoin. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec nous à info@keirsurgical.com

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES ENDOSCOPES

ÉQUIPEMENT D'ENDOSCOPIE **40**

Boroscopes d'inspection 40

Sécheur de Canal D'instrumentation 43

NETTOYAGE DES ENDOSCOPES **44**

Brosses spéciales scope 45

Brosses pour Valves 46

Trousses De Brosses 47

Brosses spéciales scope 48

Brosses réutilisables 49

Pré-nettoyage au chevet 50

DÉTERGENTS ENZYMATIQUES **50**

PROTECTION ET TRANSPORT DES ENDOSCOPES **52**

Protection de l'embout et de la gaine 52

Ensembles de Doublures de Protection 53

Sacs de transport pour endoscopes 54

Plateaux de transport pour endoscopes 55

Bacs de transport d'endoscopes 56


Étiquettes pour endoscopes 57

BOROSCOPES D'INSPECTION

Boroscopes flexibles de qualité médicale

Vidéo Scope

Que se cache-t-il dans vos instruments ?

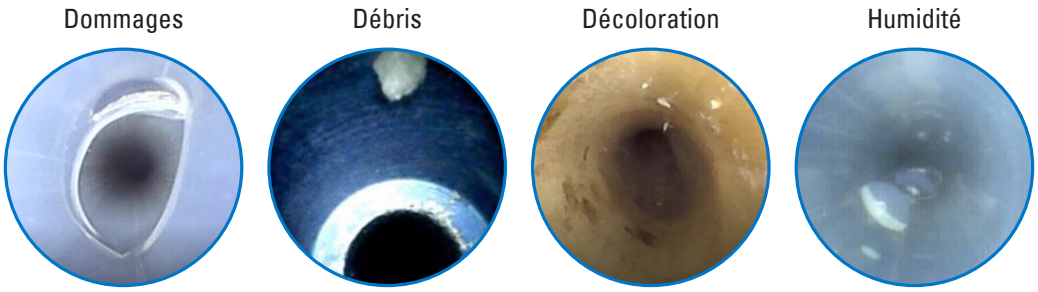

Visualiser - Illuminer - Amplifier - Documenter







CODE	DESCRIPTION	CANAL COMPATIBLE
CD-USB	Module de contrôle d'inspection double, sortie USB	
CD-HDMI	Module de contrôle d'inspection double, sortie HDMI	
CB2-60	Boroscope d'inspection, diamètre extérieur 1,83 mm, longueur de travail 60 cm	> 2,0 mm
CB2-110	Boroscope d'inspection, diamètre extérieur 1,83 mm, longueur de travail 110 cm	> 2,0 mm
CB2-200	Boroscope d'inspection, diamètre extérieur 1,83 mm, longueur de travail 200 cm	> 2,0 mm
CB1-110	Boroscope d'inspection, diamètre extérieur 1,06 mm, longueur de travail 110 cm	> 1,1 mm

Remarque - logiciel inclus pour la capture d'images et de vidéos

800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

SYSTÈME DE RINÇAGE D'ENDOSCOPE



torvan medical

- Système mains libres
- Écran ACL de 7 po
- Contrôle de pompes multiples
- Commande gestuelle
- Cordon d'alimentation et bloc d'alimentation de qualité médicale de 6 pi
- Vérification de dose avec cylindre gradué de 250 mm

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ PQT
T8-TPS-FLUSH	Système de pompe de rinçage Torvan	8" x 8.5" x 10"	1
T8-TPS-TUBESET	Ensemble de tubulure Torvan, non stérile	-	1

SÉCHEUR DE CANAL D'INSTRUMENTATION

Sécheur Airtime pour endoscopes flexibles

airtime
CYGNUS MEDICAL
aspen surgical



- Séchez deux (2) endoscopes simultanément avec deux (2) pompes et minuteries indépendantes
- Sécurité du capteur de pression de ligne intégrée
- Temps de séchage réglables



Adaptateurs, tubes et filtres

- Compatible avec Olympus, Pentax, Fuji, Storz et ACMI et de nombreux endoscopes de petit diamètre
- Contactez Keir Surgical pour personnaliser une liste de vos consommables requis

CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
VFR100	Séchoir pour endoscopes flexibles Airtime™	1
APSO6	Power Supply for Airtime Unit	1

SÉCHEUR DE CANAL D'INSTRUMENTATION

Kit de montage

airtime
CYGNUS MEDICAL
aspen surgical



Système de rail mural

Espace mural de 3'6" nécessaire.



Support de comptoir



Support de montage mural

Permet de monter une unité de séchage.



Station de séchage

CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
WRC100	Support mural Airtime™ – rail de 12 po, 2 ancrages muraux 1 support universel de montage sur rail mural, 1 pince pour rail	1
WRC500	Système de rail mural Airtime™ – quatre rails de 3 pi (embouts blancs) 2 supports pour endoscopes, 4 barres de réduction de hauteur, 12 ancrages muraux 5 supports universels de montage sur rail mural et pinces pour rail	1
CS9179	Support de comptoir avec support universel	1
2ADS-C04	Station de séchage Airtime™ – comprend (4) plateaux en fibre de verre, (4) ensembles de tubulure DF400Z (2 ensembles), (1) ensemble de tubulure DF300C, (2) bacs de rangement, 23 po (L) x 21 po (P) x 44 po (H)	1


CHOISIR LES BROSSES APPROPRIÉES POUR LES ENDOSCOPES

ÉLIMINEZ LES INCERTITUDES DANS LE CHOIX DES BROSSES

Renseignez-vous sur notre consultation gratuite de brosses !

Avec : PMC™ LES BROSSES

DES CONSEILS POUR CHOISIR UNE BROSSE :

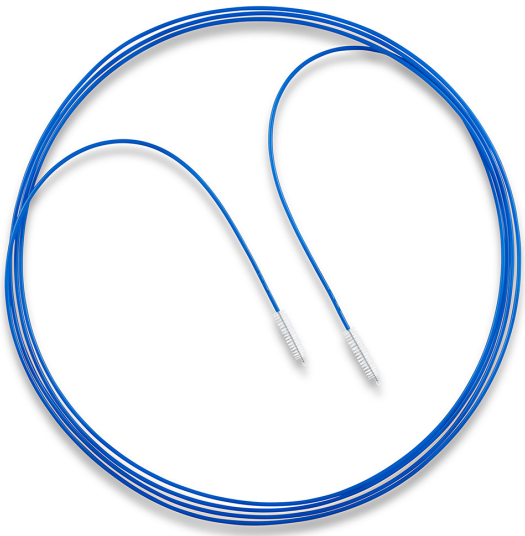

1

CANAUX

Identifiez les canaux/ports d'endoscope nécessitant un brossage pour chaque modèle.

2

TECHNIQUE

Examinez la méthode de brossage exigée par les instructions d'utilisation - nombre de balayages; pousser ou tirer à travers.

3

TAILLE APPROPRIÉE



Les normes CSA mettent l'accent sur la taille des brosses pour un bon nettoyage des canaux et la prévention des dommages.

Vérifiez que les caractéristiques techniques des canaux de la marque et du modèle d'endoscope sont compatibles avec les diamètres et longueurs min/max des canaux de la brosse. Référez-vous à la colonne correspondante dans les tableaux des produits PMC.

BROSSES SPÉCIALES SCOPE



À usage unique

Brosses pour canal

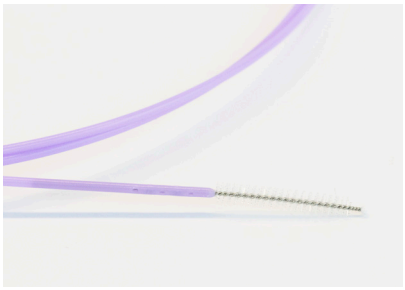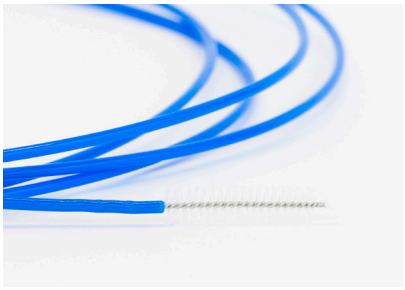CODE	COULEUR GAINE	DIAMÈTRE BROSSE	COMPATIBLE CANAL	LONGUEUR	TYPE DE SCOPE	QTÉ PQT
CB-0002-100	Blanc	2,0 mm	1,2-1,5 mm	100 cm	Micro-canal	50
CB-0003-120	Violet	3,0 mm	2,0-2,2 mm	120 cm	Broncho/Cysto	50
CB-0005-230	Bleu	5,0 mm	2,0-4,5 mm	230 cm	Endoscopes Gastro	50
CB-0510-230	Blue	5,0 mm	2,0-4,5 mm	230 cm	Brosse Jumbo	50

Brosses pour canal double


CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE BROSSE	CANAL COMPATIBLE	LONGUEUR	QTÉ PQT
CB1015	Gaine jaune	2,0 mm	1,2-1,5 mm	100 cm	100
4665	Gaine verte	5,0-6,0 mm	> 2,0 mm	100 cm	25
CB2024-L	Gaine blanche	3,0 mm	2,0-2,4 mm	230 cm	50
CB2845	Gaine bleue	5,0 mm	2,8-4,5 mm	230 cm	50
4660	Gaine bleue	5,0-6,0 mm	> 2,0 mm	260 cm	25

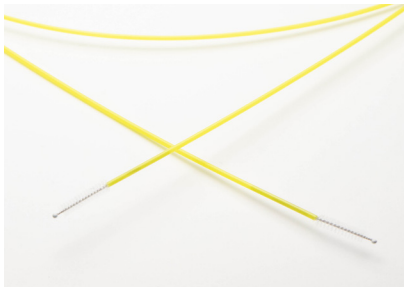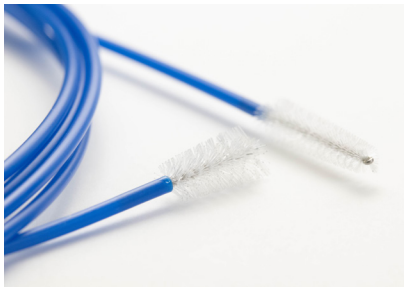BROSSES POUR VALVES

À usage unique



Brosses de nettoyage des valves

CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE DE LA BROSSE	LONGUEUR	QTÉ PQT
VCB-10	Une extrémité	10 mm	7 cm	100
VCB-0511-15	Double extrémité	5 mm & 11 mm	15 cm	100


800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

TROUSSES DE BROSSES

Endoscopie flexible, à usage unique

- Cathéter coloré permettant une identification rapide des différentes tailles de brosses
- Facile à utiliser, emballé individuellement
- Comprend une brosse de canal ainsi qu'une brosse combinée pour valve/port

Avec : PMC™ LES BROSSES

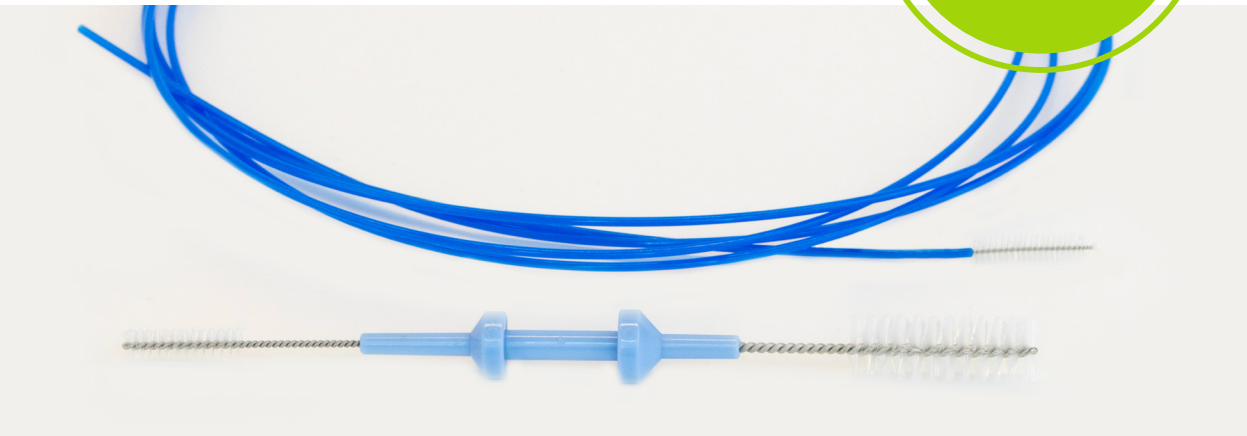

BROSSES À EXTRÉMITÉ SIMPLE

CODE	COULEUR GAINE	DIAMÈTRE BROSSE	COMPATIBLE CANAL	LONGUEUR	TYPE DE SCOPE	QTÉ PQT
KIT-0002-100	Blanc	2,0 mm	1,0-1,7 mm	100 cm	Micro-canal	50
KIT-0003-120	Violet	3,0 mm	2,0-2,2 mm	120 cm	Broncho/Cysto	50
KIT-0005-230	Bleu	5,0 mm	2,0-4,5 mm	230 cm	Endoscopes Gastro	50

BROSSES À EXTRÉMITÉ DOUBLE


CODE	COULEUR GAINE	DIAMÈTRE BROSSE	COMPATIBLE CANAL	LONGUEUR	TYPE DE SCOPE	QTÉ PQT
KIT-0202-100	Blanc	2,0 mm	1,0-1,7 mm	100 cm	Micro-canal	50
KIT-0303-120	Violet	3,0 mm	2,0-2,2 mm	120 cm	Broncho/Cysto	50
KIT-0303-230	Violet	3,0 mm	2,0-2,2 mm	230 cm	Gastro Pédiatrique	50
KIT-0505-230	Bleu	5,0 mm	2,0-4,5 mm	230 cm	Endoscope Gastro	50
KIT-0505-250	Bleu	5,0 mm	> 2,8 mm	250 cm	Entéroscopes	50

Note –Les KITS comprennent également la brosse VCB-0511-15 pour valves de 5/11mm.

BROSSES SPÉCIALES SCOPE


À usage unique

Modèles de brosses à tirer une passe

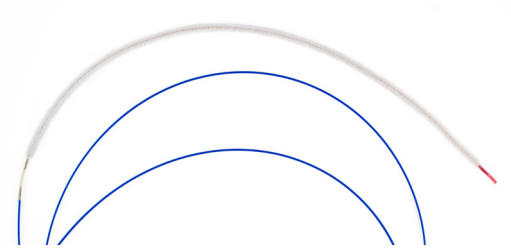

Brosse Caterpillar ™
Longueur de la tête de la brosse de 30 cm

CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE BROSSE	CANAL COMPATIBLE	LONGUEUR	QTÉ PQT
CAT-1	Gaine bleue	-	2,7-4,5 mm	230 cm	100
CAT-2	Gaine verte	-	2,0-2,2 mm	120 cm	100

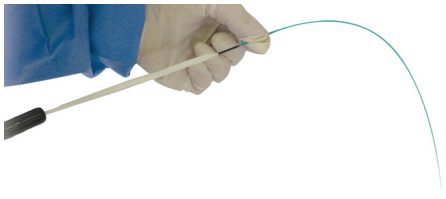

Brosse Dragontail™
Brins de microfibre

CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE BROSSE	CANAL COMPATIBLE	LON-GUEUR	QTÉ PQT
DT2022	Gaine couleur sarcelle	-	2,0-2,2 mm	110 cm	100
DT2832	Gaine violette	-	2,8-3,2 mm	230 cm	100
DT3542	Gaine rose	-	3,5-4,2 mm	230 cm	100

800.663.4525 info@keirsurgical.com keirsurgical.com

BROSSES RÉUTILISABLES

Brosses pour valves





CODE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE BROSSE	LONGUEUR BROSSE	QTÉ PQT
8500	Rouge, à double extrémité	12,0 et 4,0 mm	2,5 et 1 cm	5
DV-82	Noire, à double extrémité	11,0 et 4,0 mm	4 et 1 cm	5
SV-80	Noire, à une seule extrémité	11,0 mm	4 cm	5

Brosses pour canal





CODE	DIAMÈTRE BROSSE	CANAL COMPATIBLE	LONGUEUR GAINE	QTÉ PQT
8202	0,8 mm	> 1,0 mm	120 cm	2
8204	2,0 mm	> 1,4 mm	120 cm	2
8206	3,0 mm	> 1,8 mm	120 cm	2

PRÉ-NETTOYAGE AU CHEVET

À usage unique

Fournitures de pré-nettoyage au chevet

Sans danger pour une utilisation sur des endoscopes flexibles

ÉTAPE 1:



Utilisez le tampon texturisé pour essuyer le tube d'insertion.

ÉTAPE 2:



Aspirez le fluide restant directement de l'emballage pour dégager le canal.

CODE	DESCRIPTION	VOLUME	QTÉ PQT
EP-3	Kit de pré-nettoyage pour chevet prêt à l'emploi avec Tampon texturisé	100 ml	100
EP-4	Kit de pré-nettoyage pour chevet prêt à l'emploi avec Tampon texturisé	200 ml	70
EP-4-30	Kit de pré-nettoyage pour chevet prêt à l'emploi avec Tampon texturisé	200 ml	Palette = 2100
EP-6	Kit de pré-nettoyage pour chevet prêt à l'emploi avec Tampon texturisé	500 ml	30
EP-6W	Ajoutez l'eau à la trousse de pré-nettoyage pour chevet avec tampon texturisé	500 ml	120

Trousses de décontamination



Concentré pré-mesuré (trousses de 4 et 6 gallons), 1 trousse par endoscope

CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
EDK04	Détergent enzymatique Simple2 se mélange avec 4 gallons d'eau, un tampon texturisé	100
EP15G	Détergent enzymatique Simple2 se mélange avec 6 gallons d'eau, un tampon texturisé	100

LINGETTES ET TAMPONS DE NETTOYAGE

À usage unique

Clear Path™ lingettes en microfibres

- Capture les spores et autres pathogènes viables à un niveau microscopique
- Technologie en microfibres fendue non tissée, à faible émission de particules
- Compatible avec toutes les marques de désinfectants pour surfaces
- Efficace contre les pathogènes super-bactériens tels que C. Diff., VRE, CRE et le norovirus



Draco™ Tampons de nettoyage en profondeur

- Nettoyage en profondeur non abrasif
- Côté en microfibre – capte les particules microscopiques



Tampons de nettoyage enzymatique à double texture

- Côté rugueux et côté lisse adaptés à tous les instruments.
- Humidifiez avec de l'eau pour activer le détergent.
- Le détergent enzymatique multi-niveaux dissout efficacement le sang, la graisse, les tissus, les protéines et la plupart des autres formes de matières organiques
- Non toxique, au pH neutre et sûr pour tous les instruments chirurgicaux



Éponge sèche

S'adapte autour de la gaine du scope



Tampons texturisés à sec

Utilisez moins de mousse tout en facilitant l'enroulement autour de la gaine du scope

CODE	DESCRIPTION	TAILLE	QTÉ PQT
W5412-30	Clear Path™ Lingettes microfibres (20 sacs imperméable de 30 lingettes)	8" x 12"	600
W5412-150	Clear Path™ Lingettes microfibres (8 sacs de 150 lingettes)	10" x 12"	1200
PW0909100	Clear Path™ Microfiber Wipes (6 bags of 100 wipes)	9"x9"	100
HY0305	DRACO tampons de nettoyage en profondeur	3,5" x 5"	100
SC-50	Éponge sèche à récurer	9,5 cm L	50
3550DT	Tampons enzymatiques double texturisés	3,5" x 5"	100
3550K	Tampons de nettoyage texturisés à sec	3,5" x 5,5"	200

PROTECTION DES ENDOSCOPES

À usage unique

Les laboratoires GI ont rapporté jusqu'à une réduction de 50 % du remplacement des gaines de flexion grâce à la protection des embouts



BC-50 BCB-50

Protecteur d'embout – mousse



NA2500

Protecteur d'embout – non absorbant



KS01-1000B

Protecteur d'embout – taille unique / conception universelle



ESP789501

Manchon pour endoscope, grand format

CODE	DESCRIPTION	QTÉ PQT
BC-50	Protecteur d'extrémité d'endoscope – grand	50
BCB- 50	Protecteur d'extrémité d'endoscope – petit	50
NA2500	Protecteur d'endoscope non absorbant	200
KS01-1000B	Compatible avec une plage de 2,5 mm à 14 mm. La conception universelle favorise la circulation de l'air	100
ESP789501	Barrière contre l'environnement et les autres endoscopes	100

ENSEMBLES DE DOUBLURES DE PROTECTION

Usage multiple

Plastique découpé en deux, utilisable des deux côtés grâce à une doublure réversible !



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ PQT
KS02-4000	Doublure de plateau de protection réversible, à usage unique	57CM x 57CM	300/ boîte

SACS DE TRANSPORT POUR ENDOSCOPES

À usage unique



SIGNAL™ Sacs de Transport

IDENTIFIE CLAIREMENT les scopes souillés, protégeant ainsi le personnel et les patients
COMPOSTABLE (normes ASTM D6400)





Sacs biodégradables et souillés



Nappe kangourou

Convertir la nappe en un sac de confinement pour l'endoscope souillé

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L	QTÉ PQT
KP100	Nappe Kangourou - Bleu	41" x 36"	100
SB24W	Sac pour endoscope souillé - Blanc	24" x 24"	100
HLD22	Sac biodégradable pour endoscope souillé - vert	22" x 22"	100
ITB1218	SIGNAL™ – Sac de transport compostable	12" x 18"	200
ITB2022	SIGNAL™ – Sac de transport compostable	20" x 22"	200
ITB1218-H	SIGNAL™ – Sac de transport compostable avec étiquette HLD	12" x 18"	200
ITB2022-H	SIGNAL™ – Sac de transport compostable avec étiquette HLD	20" x 22"	200

PLATEAUX DE TRANSPORT POUR ENDOSCOPES

À usage unique

- Construction rigide protégeant les endoscopes.
- Optimisation de l'espace – empilable et emboîtable



OT1230



OP1330



Pour connaître les caractéristiques techniques des chariots, veuillez contacter votre représentant Keir Surgical

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L	QTÉ PQT
OT1016	Oasis® Petit récipient de transport d'endoscope – couvercle réversible, sans réservoir	16" x 10"	50
OT1230NH	Oasis® Récipient de transport – couvercle réversible- réservoir intégré	20,5" x 16,5"	30
OT1230NH-16	Oasis® Récipient de transport – couvercle réversible, réservoir intégré – Palette de 16 boîtes	20,5" x 16,5"	480
OP1330	Oasis® PLUS Récipient de transport – couvercle réversible – pas de réservoir	21,5" x 19,5"	30
OP1330-16	Oasis® PLUS Récipient de transport – couvercle réversible – pas de réservoir – Palette de 16 boîtes	21,5" x 19,5"	480

BACS DE TRANSPORT D'ENDOSCOPES

Réutilisables

Conteneur de transport

- Grande résistance à la chaleur et aux produits chimiques
- Couleur ambre translucide
- Verrouillage facile, couvercle amovible



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L x H
IN-PIC-11	Grande taille	20,6 x 15,6 x 7,5"
IN-PIC-12	Grand court	20,6 x 15,6 x 5,3"
IN-PIC-13	Petite taille	13,6 x 15,6 x 7,5"
IN-PIC-14	Petit court	13,6 x 15,6 x 4,3"
IN-PIC-15	Conteneur de transport, XL court	20,5 x 12,625 x 3,75"
IN-PIC-16	Conteneur de transport, XL grand	20 x 12,25 x 6,125"

Conteneur de transport XL

- Conçu pour le transport des endoscopes da Vinci SP®, da Vinci Xi® et des instruments EndoWrist®
- Parfaitement associé pour tremper et protéger vos instruments pendant le transport du bloc opératoire au département de traitement stérile



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x W x H
IN-PIC-20	Conteneur de transport XL	34" x 17 1/4" x 6"
IN-PIC-20-D	Conteneur de transport XL avec égouttoir	34" x 17 1/4" x 6"
IN-PIC-34	Plateau élévateur	27 1/2" x 13 1/2" x 3 7/8"
IN-PIC-20-D-LT	Conteneur de transport XL avec égouttoir + plateau élévateur	34" x 17 1/4" x 6"
IN-PIC-20-LT	Conteneur de transport XL + plateau élévateur	34" x 17 1/4" x 6"

ÉTIQUETTES POUR ENDOSCOPES COUNTDOWN™

À usage unique





MOIS/JOUR ou ÉTIQUETTES QUOTIDIENNES

- Les informations dont vous avez besoin, en un coup d'œil
- Des étiquettes clairement marquées permettent d'identifier rapidement le moment où les instruments ont été retraités, ce qui permet de respecter les normes industrielles relatives aux intervalles d'entreposage
- Bande adhésive sensible à la pression
- Code couleur pour le jour de la semaine
- Sans latex

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ PQT
CDM610	Lundi – 4 pqts de 100	12" x 1,75"	400
CDT620	Mardi – 4 pqts de 100	12" x 1,75"	400
CDW630	Mercredi – 4 pqts de 100	12" x 1,75"	400
CDTH640	Jeudi – 4 pqts de 100	12" x 1,75"	400
CDF650	Vendredi – 4 pqts de 100	12" x 1,75"	400
CDS660	Samedi – 4 pqts de 100	12" x 1,75"	400
CDSUN670	Dimanche – 4 pqts de 100	12" x 1,75"	400
CDCOMB700	Chaque jour de la semaine – 100 étiquettes	12" x 1,75"	700

MEILLEURES PRATIQUES


La norme CSA Z314-18 sur le retraitement des dispositifs médicaux au Canada indique, à la section 12.5.4 (durée de conservation des endoscopes) et 1.3.1.3 :

Un processus doit être en place afin d'identifier la date de retraitement de chaque endoscope




CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ PQT
CD300	Mois/ jour – 2 pqts de 100	12" x 1,75"	200

ÉTIQUETTES POUR ENDOSCOPES KEIR SURGICAL



KS02-2003

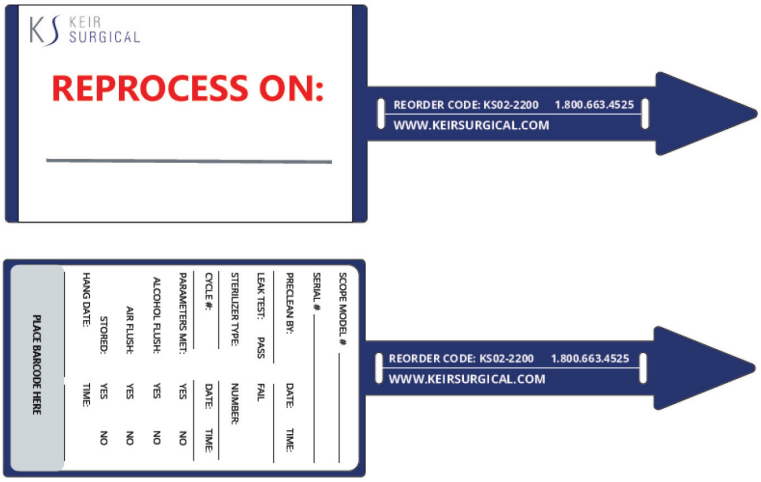

KS02-2200

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	QTÉ PQT
KS02-2001	Étiquette pour endoscope - blanche	13.25" X 1.5"	100
KS02-2002	Étiquette pour endoscope - bleue	13.25" X 1.5"	100
KS02-2003	Étiquette pour endoscope - verte	13.25" X 1.5"	100
KS02-2004	Étiquette pour endoscope - rouge	13.25" X 1.5"	100
KS02-2005	Étiquette pour endoscope - jaune	13.25" X 1.5"	100
KS02-2006	Étiquette pour endoscope - violette	13.25" X 1.5"	100
KS02-2007	Étiquette pour endoscope - orange	13.25" X 1.5"	100
KS02-2200	Étiquette de traitement pour endoscope - blanche	10" x 3"	100

INDEX DES PRODUITS

2ADS-C04	43	4563-OLY	12	6566	26	AG-5335-241023	13
16-0002	9	4564-OLY	12	6567	26	AG-5335-241523	13
16-0004	9	4565-OLY	12	6571	26	AG-5336-241023	13
16-0022	9	4567-OLY	12	6572	26	AG-5336-241523	13
16-0044	9	4573-OLY	12	6574	26	AG-50121-2323	18
1177-01	12	4660	45	6575	26	AG-50122-2323	18
1180-01	14	4665	45	6576	26	AG-50123-2323	18
1180-02	14	4702	15	6582	26	AG-50124-2323	18
1180-03	14	4704	15	6584	26	AG-50210-2823	19
1180-04	14	4706	15	6585	26	AG-50211-2823	19
1180-10	14	4708	15	8202	49	AG-50212-2823	19
1180-11	14	4714	15	8204	49	AG-50213-2823	19
1180-12	14	4718	15	8206	49	AG-50214-2823	19
1180-13	14	4720	15	8500	49	AG-50215-2823	19
1180-14	14	4721	15	11060	30	AG-50216-2823	19
1180-15	14	4722	15	11065	30	AG-51018-2300-090-13	17
1204-08	22	4723	15	11090	30	AG-51018-2300-135-13	17
1204-10	22	5030S	11	11160	29	AG-51044-2300-090-16	17
1204-12	22	6102	24	11170	29	AG-51044-2300-135-16	17
1204-15	22	6103	24	25390	30	APSO6	42
1204-18	22	6104	24	25395	30	BC-50	52
1204-20	22	6106	24	AG-5021-2316	18	BCB- 50	52
1205-08	23	6107	24	AG-5022-2316	18	CAPSOCAM-PLUS	10
1205-10	23	6132	25	AG-5023-2316	18	CAT-1	48
1205-12	23	6134	25	AG-5024-2316	18	CAT-2	48
1205-18	23	6136	25	AG-5029-2823	19	CB1-110	40
1205-20	23	6138	25	AG-5032-1823	33	CB2-60	40
2190	27	6341	25	AG-5075-241023	13	CB-0002-100	45
2305-15	23	6342	25	AG-5075-241523	13	CB2-110	40
3550DT	51	6351	25	AG-5075-242523	13	CB2-200	40
3550K	51	6352	25	AG-5075-243223	13	CB-0003-120	45
4102	36	6532	26	AG-5076-241023	13	CB-0005-230	45
4104	20	6541	26	AG-5076-241523	13	CB-0510-230	45
4106	20	6542	26	AG-5078-241523	13	CB1015	45
4108	20	6544	26	AG-5078-242523	13	CB2024-L	45
4110	20	6545	26	AG-5081-2423-2104	16	CB2845	45
4112	20	6546	26	AG-5081-2423-2106	16	CD300	57
4202	36	6551	26	AG-5082-2423-2304	16	CDAS	10
4204	36	6552	26	AG-5082-2423-2306	16	CDCOMB700	57
4206	36	6554	26	AG-5083-2423-2504	16	CDF650	57
4310	37	6555	26	AG-5083-2423-2506	16	CD-HDMI	40
4320	21	6561	26	AG-5104-2300-090	17	CDM610	57
4352	21	6562	26	AG-5104-2300-135	17	CDS660	57
4561-OLY	12	6564	26	AG-5108-2300-090-9	17	CDSUN670	57
4562-OLY	12	6565	26	AG-5108-2300-135-9	17	CDT620	57

INDEX DES PRODUITS

CDTH640 57
CD-USB 40
CDW630 57
CS9179 43
DV-82 49
EDK04 50
EP-3 50
EP-4 50
EP-4-30 50
EP-6 50
EP-6W 50
EP15G 50
ESP789501 52
ESP789501 52
ET1301 15
ET1303 15
ET1321 15
ET1323 15
HLD22 54
HY0305 51
IN-PIC-11 56
IN-PIC-12 56
IN-PIC-13 56
IN-PIC-14 56
IN-PIC-15 56
IN-PIC-16 56
IN-PIC-20 56
IN-PIC-20-D 56
IN-PIC-20-D-LT 56
IN-PIC-20-LT 56
IN-PIC-34 56
ITB1218 54
ITB1218-H 54
ITB2022 54
ITB2022-H 54
KIT-0002-100 47
KIT-0003-120 47
KIT-0005-230 47
KIT-0202-100 47
KIT-0303-120 47
KIT-0303-230 47
KIT-0505-230 47
KIT-0505-250 47
KP100 54
KS01-1000B 52
KS01-1000B 52
KS02-2001 58
KS02-2002 58
KS02-2003 58
KS02-2004 58
KS02-2005 58
KS02-2006 58
KS02-2007 58
KS02-2200 58
KS02-4000 53
KS02-8001 6
KS02-8002 7
KS02-8004 7
KS02-9016 8
KS02-9016 31
KS02-9016N 8
KS02-9016N 31
KS02-9019 8
KS02-9019 31
KS02-9020 8
KS02-9020 31
KS02-9021 8
KS02-9021 31
KS02-9022 8
KS02-9022 31
NA2500 52
OP1330 55
OP1330-16 55
OT1016 55
OT1230NH 55
OT1230NH-16 55
PT-25 6
PT-25X 6
PT-100 6
PT-100X 6
PW0909100 51
SB24W 54
SC-50 51
SV-80 49
T8-TPS-FLUSH 41
T8-TPS-TUBESET 41
VCB-10 46
VCB-0511-15 46
VDK-BC-18-105-A 37
VDK-BC-18-105-B 37
VDK-BC-18-105-C 37
VDK-BC-18-110-C 37
VDK-BC-18-110-C-2 37
VDK-BC-18-115-C 37
VDK-BC-18-120-A 37
VDK-BC-18-120-B 37
VDK-BC-18-120-C 37
VDK-BC-18-160-C 21
VDK-BC-18-180-C 21
VDK-BC-23-105-B 21
VDK-BC-23-105-C 21
VDK-BC-23-160-B 21
VDK-BC-23-160-C 21
VDK-BC-23-180-C 21
VDK-BC-23-230-B 21
VDK-BC-23-230-C 21
VDK-FB-18-105-O-O-B1 34
VDK-FB-18-105-O-P-A1 34
VDK-FB-18-105-O-P-B1 34
VDK-FB-18-105-W-O-B1 34
VDK-FB-18-105-W-P-B1 34
VDK-FB-18-160-O-P-B1 34
VDK-FG-18-120-C1 32
VDK-FG-18-120-C2 32
VDK-FG-18-120-C3 32
VDK-FG-18-160-C1 32
VDK-FG-18-160-C2 32
VDK-FG-18-160-C3 32
VDK-FG-25-230-C1 11
VDK-FG-25-230-C1R 11
VDK-FG-25-230-C2 11
VDK-FG-25-230-C2R 11
VDK-FG-25-230-C3 11
VDK-FG-25-230-C3R 11
VDK-FG-25-230-C4 11
VDK-FG-25-230-C4R 11
VDK-FG-25-230-C5 11
VDK-MFB-80-B1 35
VDK-MFB-120-B1 35
VDK-MFB-180-B1 35
VDK-MFB-230-B1 35
VDK-MFB-260-B1 35
VDK-MFB-290-B1 35
VFR100 42
W5412-30 51
W5412-150 51
WRC100 43
WRC500 43

NOTES

NOTES

KEIR SURGICAL

INSTRUMENTS FOR LIFE
DES INSTRUMENTS POUR LA VIE

SIÈGE SOCIAL
Tel : 800.663.4525 or 604.261.9596 | Fascimile : 604.261.9549
126-408 East Kent Avenue South, Vancouver, BC V5X 2X7

BUREAU RÉGIONAL DE L'EST
Tel : 800.663.4525 ou 514.277.5347 | Fascimile : 514.270.5340
9460 Route Transcanadienne, Saint-Laurent, QC H4S 1R7

info@keirsurgical.com | www.keirsurgical.com

PACIFIC SURGICAL

Keir Surgical is a Pacific Surgical Company
Keir Surgical est une filiale de Pacific Surgical